


Poziomowskazy magnetyczne

Seria wysokociśnieniowa

Seria	Type	Materiał	Komora O.D. x s (mm)	Ciśnienie Robocze	Temperatura Robocza	Strona
Wysokociśnieniowa 80	36800-A	316/316L	57.0 x 2.9	max. 80 bar@ 20°C	-10...400°C	2
"	36800-B	"	"	"	"	3
"	36800-K	"	"	"	"	4
"	36800-O	"	"	"	"	5
"	Wykres ciśnienie – temperatura dla Serii Wysokociśnieniowej 80					6
"	Diagram doboru pływaka dla Serii Wysokociśnieniowej 80					7
Wysokociśnieniowa 100	26411-A	316/316L	57.0 x 2.9	max. 100 bar@ 20°C	-10...400°C	8
"	26411-B	"	"	"	"	9
"	26411-K	"	"	"	"	10
"	26411.O	"	"	"	"	11
"	Wykres ciśnienie – temperatura dla Serii Wysokociśnieniowej 100					12
"	Diagram doboru pływaka dla Serii Wysokociśnieniowej 100					13
Wysokociśnieniowa 150	25683-A	316/316L	60.33 x 3.91	max. 150 bar@ 20°C	-10...400°C	14
"	25683-B	"	"	"	"	15
"	25683-K	"	"	"	"	16
"	25683-O	"	"	"	"	17
"	Wykres ciśnienie – temperatura dla Serii Wysokociśnieniowej 150					18
"	Diagram doboru pływaka dla Serii Wysokociśnieniowej 150					19
Wysokociśnieniowa 200	32806-A	316/316L	60.33 x 5.54	max. 200 bar@ 20°C	-10...400°C	20
"	32806-B	"	"	"	"	21
"	32806-K	"	"	"	"	22
"	32806-O	"	"	"	"	23
"	250-PN400 w zależności od zamówienia					24
"	Wykres ciśnienie – temperatura dla Serii Wysokociśnieniowej 200					25
"	Diagram doboru pływaka dla Serii Wysokociśnieniowej 200					26
				250-400 w zależności od zamówienia		27
				Karta katalogowa dla wskaźników wysokociśnieniowych		28
Akcesoria						29

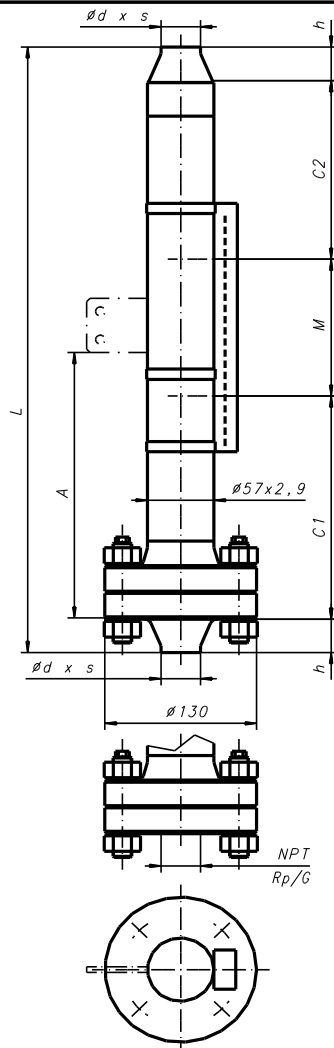

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	200	150
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe, W zależności od pływaka!	

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

a) Końcówki spawane:

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25

- ANSI/ISO:

DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Projekt:

Ilość:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

> 0.6g/cm3

maks. 80bar(g) @ 20 °C *1)

"

-10 °C bis max. 400 °C *1)

"

g/cm3:

bar(g):

bar(g):

°C:

°C:

*1) Należy zapoznać się przebieg ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe / NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

typ:

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 6000mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Niestandardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

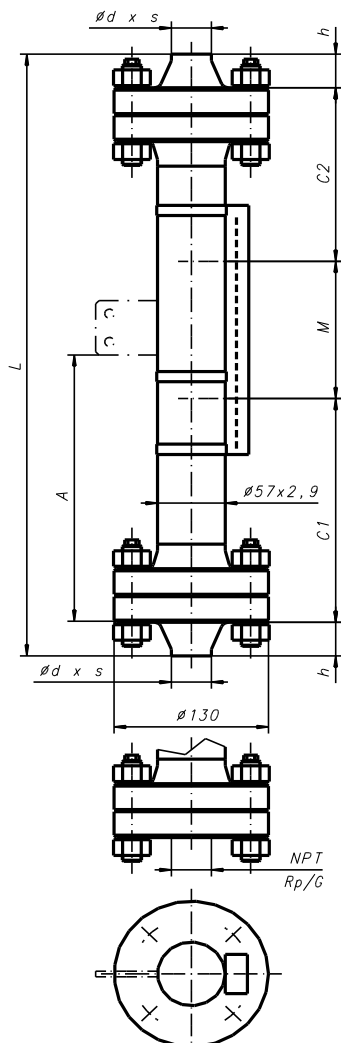
Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	200	155
Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe, W zależności od pływaka!		

Standardowe przyłącza kołnierzowe:
a) Końcówki spawane:

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25
- ANSI/ISO:		
DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Projekt:

Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 6000mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:
Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:



Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory płwaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

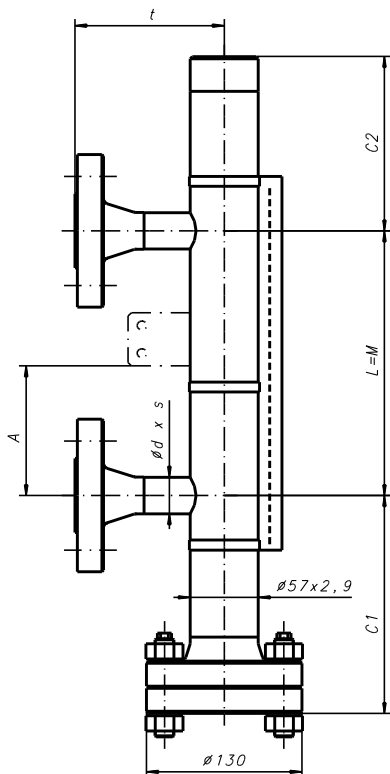

Zasięg płwaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	200	150
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe,	
	W zależności od płwaka!	

Standardowe przyłącza kołnierkowe:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!

Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość :
Ciśnienie pracy :
Ciśnienie projektowe:
Temperatura pracy :
Temperatura projektowa:

*1) Należy zapoznać się przebieg ciśnienia i temperatury!
Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!
Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora płwaka: standardowe wykonanie:
Płwak: 316/316L
Śruby DIN 2510 L: stop tytanu typ:
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard
czyste PTFE bez wzmocnienia
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytki: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard
Al, kat.-nr. 20010405: Płytki: nr:
Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr. mm:

Przyłącza kołnierkowe PN64/100 wg DIN-/EN:

- przyłącza kołnierkowe typu E, Rz=16 DN15:
- kołnierze wg DIN2636/2637 DN25:

Przyłącza kołnierkowe wg ANSI-/ISO , klasa 600/PN100:

- przyłącza, "klasyczna" (= "wykończenie płaskie") 1/2" bez. DN15 :
- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2 3/4" bez. DN20 :
1" bez. DN25 :

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator: typ:



Napięcie zasilające, V: AC/DC:

Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory płwaka:
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

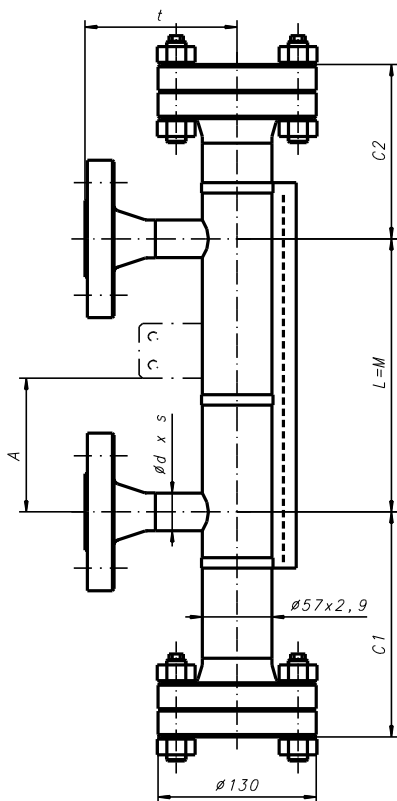

Zasięg pływaka dolny / górny:

c1: 200 c2: 155
Standard

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przyłącza kołnierkowe:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!
- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Projekt:

Ilość:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

*1) Należy zapoznać się przebieg ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczeniowe)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Przyłącza kołnierkowe PN64/100 wg DIN-/EN:

- przyłącza kołnierkowe typu E, Rz=16

- kołnierze wg DIN2636/2637

DN15:

DN25:

Przyłącza kołnierkowe wg ANSI-/ISO , klasa 600/PN100:

- przyłącza, "klasyczna" ("wykończenie płaskie")

- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2

1/2" bez. DN15 :

3/4" bez. DN20 :

1" bez. DN25 :

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

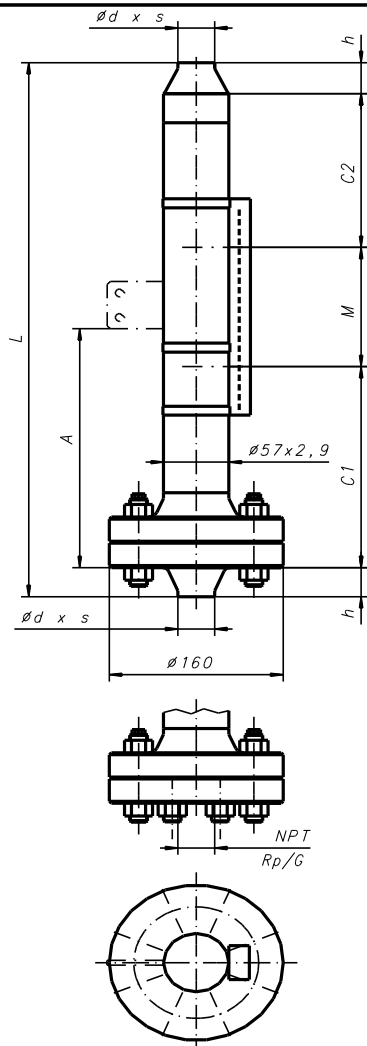**Zasięg pływaka dolny / górny:**

	c1:	c2:
Standard	200	150
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe,	
	W zależności od pływaka!	

Standardowe przyłącza kołnierzowe:**a) Końcówki spawane:**

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25

- ANSI/ISO:

DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm3 g/cm3:
Ciśnienie pracy : max. 100bar(g) @ 20 °C *1) bar(g):
Ciśnienie projektowe: " bar(g):
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1) °C:
Temperatura projektowa: " °C:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka: standardowe wykonanie: 316/316L
Pływak: stop tytanu typ:
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczeniowe)
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard
czyste PTFE bez wzmocnienia
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytki: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard
Al, kat.-nr. 20010405: Płytki: nr:

Rozstaw króćców : max. 6000mm jednoczęściowa konstr. mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Note standard dimension available as indicated!

Inne przyłącza:**Akcesoria:**

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:


Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:

Pozostałe akcesoria:**Opcjonalnie:**

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

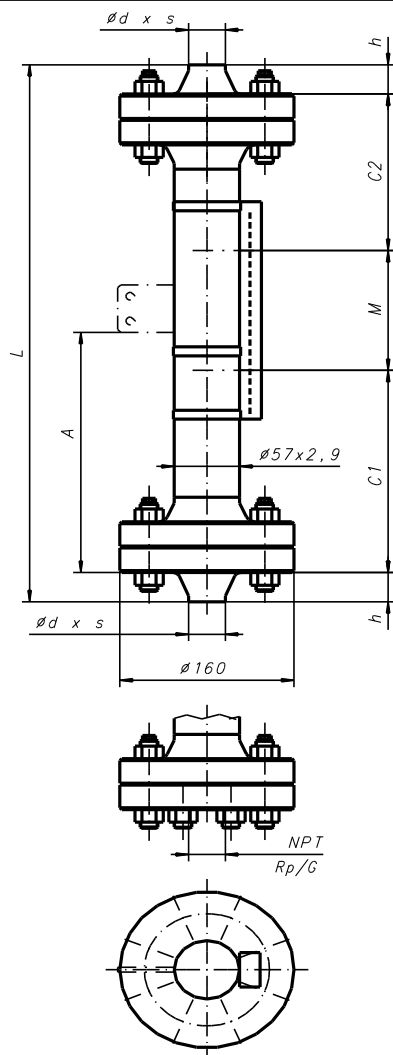**Dane zamówienia:**

Firma :
 Numer zamówienia :
 Projekt:
 Ilość:

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
 Gęstość :
 Ciśnienie pracy :
 Ciśnienie projektowe:
 Temperatura pracy :
 Temperatura projektowa:

min 0.6g/cm3	g/cm3:
max. 100bar(g) @ 20 °C *1)	bar(g):
"	bar(g):
-10 °C bis max. 400 °C *1)	°C:
"	°C:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:
 Pływak:
 Śruby DIN 2510 L:
 Nakrętki sześć. DIN2510 NF:
 Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L	
stop tytanu	typ:
21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)	
21CrMoV57-DIN17240	
Włókno Aramidowe/NBR	Standard
czyste PTFE bez wzmocnienia	
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L	

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:
 AI, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona	nr: 34837	Standard
Płytki:	nr:	

Rozstaw króćców :

max. 6000mm jednoczęściowa konstr.	mm:
------------------------------------	-----

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:

--

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	200	150
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe, W zależności od pływaka!	

Standardowe przyłącza kołnierzowe:**a) Końcówki spawane:**

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25
- ANSI/ISO:		
DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
 zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!
 - wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
 dla wykonania standardowego!
 Modyfikacja zastrzeżona.

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:	ilość:
------	--------

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:

Pozostałe akcesoria:

--


Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

--

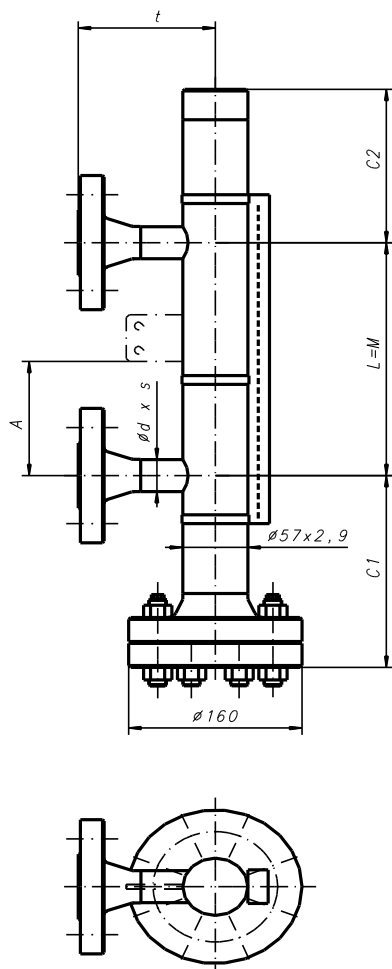

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt :
Ilość :

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm3
Ciśnienie pracy : max. 100bar(g) @ 20 °C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1)
Temperatura projektowa : "

g/cm3:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływakowa: 316/316L
Pływak: stop tytanu
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR
czyste PTFE bez wzmocnienia
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:
Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard
Płytki: nr:

Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr. mm:

Przylączy kołnierzone PN64/100 wg DIN-EN:

- przyłącza kołnierzone typu E, Rz=16 DN15: ☐
- kołnierze wg DIN2636/2637 DN25: ☐

Przylączy kołnierzone wg ANSI-ISO , klasa 600/PN100:

- przyłącza, "klasyczna" ("wykończenie płaskie") 1/2" bez. DN15 : ☐
- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2 3/4" bez. DN20 : ☐
1" bez. DN25 : ☐

Inne przylączy:

--

Zasięg pływakowy dolny / górny:

c1: c2:
Standard 200 150

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaków!

Standardowe przylączy kołnierzone:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przylączy, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:

Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływakowej:
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

--

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika


zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane

dla wykonania standardowego!

Modyfikacja zastrzeżona.

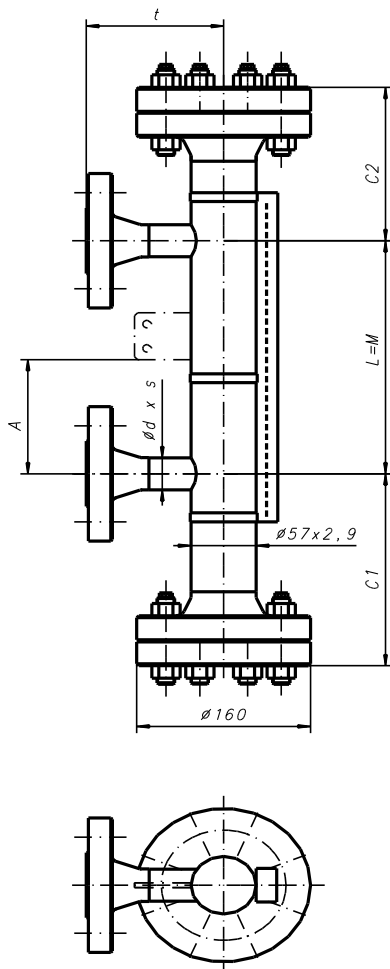

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	200	150

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Projekt:

Ilość:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Przyłącza kołnierzowe PN64/100 wg DIN-/EN:

- przyłącza kołnierzowe typu E, Rz=16

- kołnierze wg DIN2636/2637

DN15:

DN25:

Przyłącza kołnierzowe wg ANSI-/ISO , klasa 600/PN100:

- przyłącza, "klasyczna" (= "wykończenie płaskie")

- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2

1/2" bez. DN15 :

3/4" bez. DN20 :

1" bez. DN25 :

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

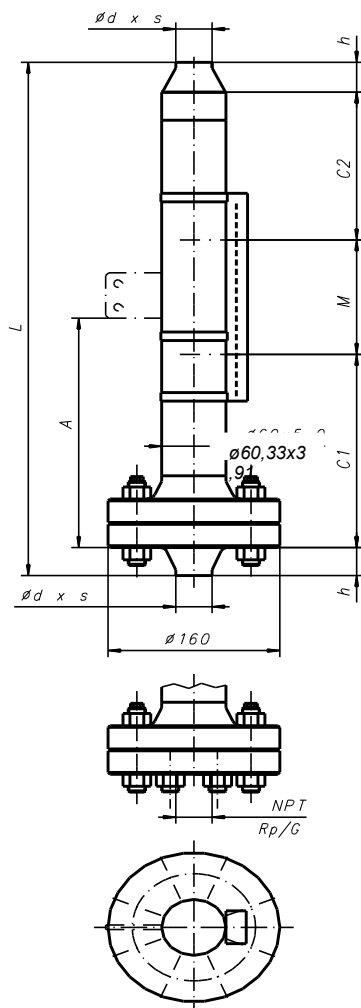**Zasięg pływaka dolny / górny:**

c1: 200 c2: 150
Standard
Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przyłącza kołnierzowe:**a) Końcówki spawane:**

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25
- ANSI/ISO:		
DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm3 g/cm3:
Ciśnienie pracy : max. 150bar(g) @ 20 °C *1) bar(g):
Ciśnienie projektowe: " bar(g):
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1) °C:
Temperatura projektowa: " °C:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka: standardowe wykonanie: 316/316L
Pływak: stop tytanu typ:
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard
czyste PTFE bez wzmocnienia
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytki: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard
AI, kat.-nr. 20010405: Płytki: nr:

Rozstaw króćców : max. 6000mm jednoczęściowa konstr. mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:**Akcesoria:**

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnal wyjściowy:

Długość pomiarowa:


Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:

Pozostałe akcesoria:**Opcjonalnie:**

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

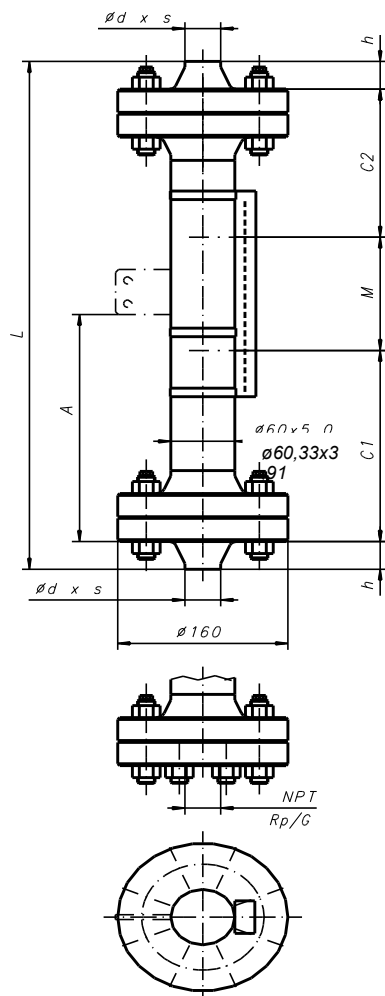

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

min 0.6g/cm3	g/cm3:
max. 150bar(g) @ 20 °C *1)	bar(g):
"	bar(g):
-10 °C bis max. 400 °C *1)	°C:
"	°C:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 6000mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:

Zasięg pływaka dolny / górny:

c1: 200 c2: 150
Standard
Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

a) Końcówki spawane:

DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25

ANSI/ISO:	h	d*s
DN15:	38	21.34*2.77
DN20:	41,5	26.67*2.87
DN25:	44,5	33.40*3.38

b) Gwinty żeńskie:

ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:

Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:


*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podane "mm"!

Wymiarowanie podane

dla wykonania standardowego!

Modifikacja zastrzeżona.

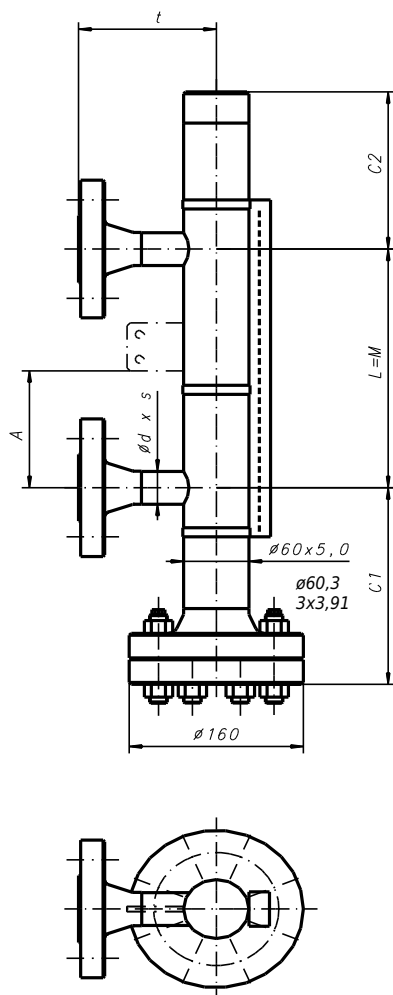

Zasięg pływaka dolny / górny:

c1: c2:
Standard 200 150

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od płwaka!

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm3
Ciśnienie pracy : max. 150bar(g) @ 20 °C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1)
Temperatura projektowa : "

g/cm3:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora płwaka: 316/316L
Pływak: stop tytanu typ:
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczeniowe)
Nakrętki sześci. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard ☐
czyste PTFE bez wzmocnienia ☐
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L ☐

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytk: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard ☐
Al, kat.-nr. 20010405: Płytk: nr:

Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr. mm:

Przyłącza kołnierzowe PN160 wg DIN-/EN:

- przyłga kołnierzowa typu E, Rz=16 DN15: ☐
- kołnierze wg DIN2638 DN25: ☐

Przyłącza kołnierzowe wg ANSI-/ISO , klasa 900/1500:

- przyłga, "klasyczna" ("wykończenie płaskie") 1/2" bez. DN15 : ☐
- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2 3/4" bez. DN20 : ☐
1" bez. DN25 : ☐

*5) kołnierze <=DN65 są takie same jak kołnierze PN250/klasa 1500

Inne przyłącza:

--

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:



Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory płwaka: ☐
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.) ☐

Wykonania specjalne, uwagi:

--

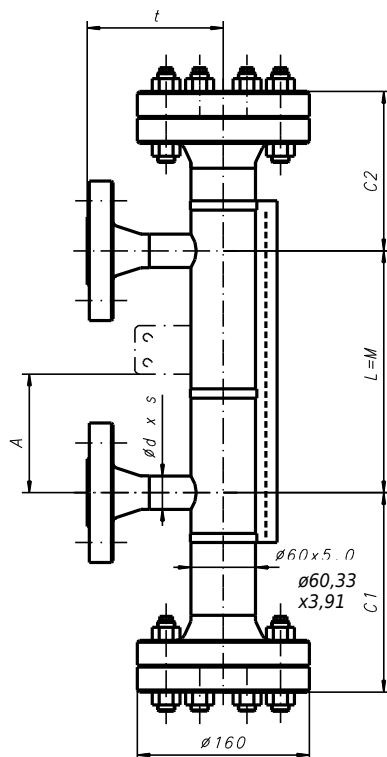

Zasięg pływaka dolny / górny:

c1: 200 c2: 150
Standard

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przyłącza kołnierzone:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*2.77
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*2.87
DN25:	33.7*3.25	33.40*3.38
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*3.38
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane

dla wykonania standardowego!

Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :

Numer zamówienia :

Projekt:

Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)

21CrMoV57-DIN17240

Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebrno-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 5600mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Przyłącza kołnierzone PN160 wg DIN-/EN:

- przyłącza kołnierzone typu E, Rz=16

- kołnierze wg DIN2638

DN15:

DN25:

Przyłącza kołnierzone wg ANSI-/ISO , klasa 900/1500:

- przyłącza, "klasyczna" (= "wykończenie płaskie")

- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2

1/2" bez. DN15 :

3/4" bez. DN20 :

1" bez. DN25 :

*5) kołnierze <=DN65 są takie same jak kołnierze PN250/klasa 1500

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

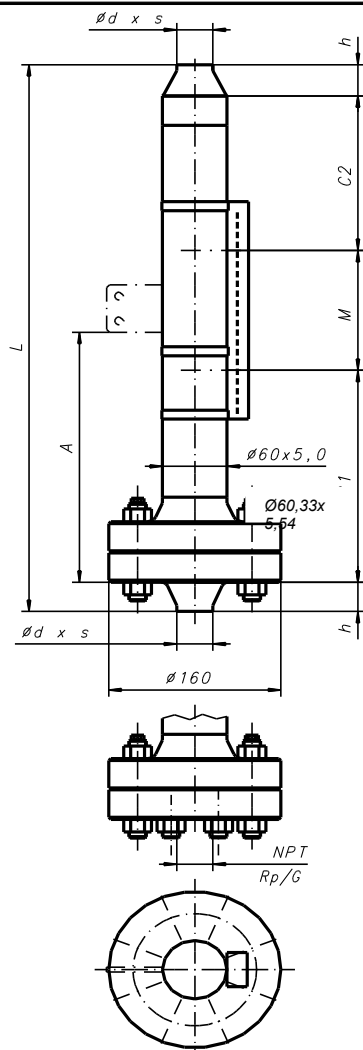

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	205	155
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe, W zależności od pływaka!	

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

a) Końcówki spawane:

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25

- ANSI/ISO:

DN15:	38	21.34*3.73
DN20:	41,5	26.67*3.91
DN25:	44,5	33.40*4.55

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

nr TAG:

Parametry pracy :

Czynnik :

Gęstość :

Ciśnienie pracy :

Ciśnienie projektowe:

Temperatura pracy :

Temperatura projektowa:

min 0.6g/cm3	g/cm3:
max. 200bar(g) @ 20 °C *1)	bar(g):
"	bar(g):
-10 °C bis max. 400 °C *1)	°C:
"	°C:

*1) Należy zapoznać się przebieg ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:

Pływak:

Śruby DIN 2510 L:

Nakrętki sześć. DIN2510 NF:

Uszczelki:

standardowe wykonanie:

316/316L

stop tytanu

Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęceniuowe)

Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240

Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR

czyste PTFE bez wzmocnienia

Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Standard

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805:

Al, kat.-nr. 20010405:

Płytki: Srebro-czerwona

Płytki:

nr: 34837

nr:

Standard

Rozstaw króćców :

max. 6000mm jednoczęściowa konstr.

mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936:

wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4):

typ:

ilość:

Sensor *4):

typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator:

typ:

Napięcie zasilające, V:

AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

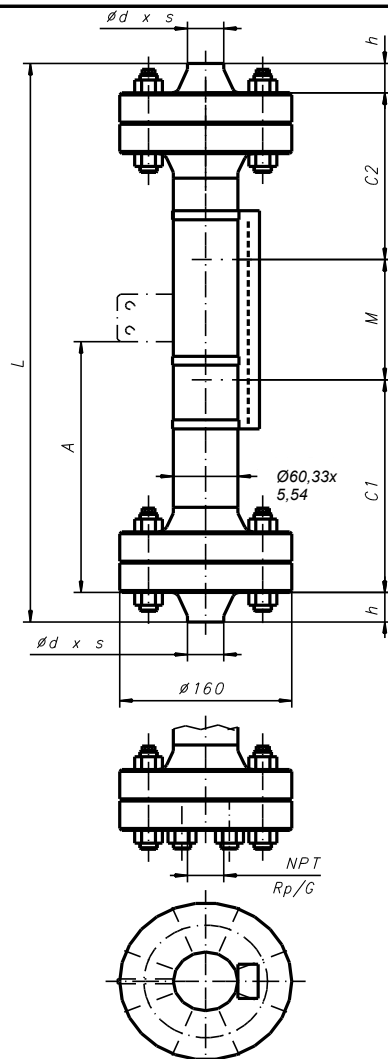

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

Parametry pracy :

Czynnik :	
Gęstość :	min 0.6g/cm3
Ciśnienie pracy :	max. 200bar(g) @ 20 °C *1)
<i>Ciśnienie projektowe:</i>	"
Temperatura pracy :	-10 °C bis max. 400 °C *1)
<i>Temperatura projektowa:</i>	"

*1) Należy zapoznać się przebieg ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka:	316/316L	
Pływak:	stop tytanu	typ:
Śruby DIN 2510 L:	21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczeniowe)	
Nakrętki sześc. DIN2510 NF:	21CrMoV57-DIN17240	
Uszczelki:	Włókno Aramidowe/NBR	Standard
	czyste PTFE bez wzmocnienia	
	Grafit ze wzmocnieniem 316/316L	

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytką: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard
Al, kat.-nr. 20010405: Płytką: nr:

Rozstaw króćców : max. 6000mm jednoczęściowa konstr. mm:

Standardowe przyłącza:

Typ i wielkość należy określić przy zamówieniu! Standardowe wymiary dostępne tak jak pokazano!

Inne przyłącza:

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	205	155
Na życzenie:	c1, c2 krótsze lub dłuższe, W zależności od pływaka!	

Standardowe przyłącza kołnierzowe:

a) Końcówki spawane:

- DIN/EN:	h	d*s
DN15:	25	21.3*2.65
DN20:	28	26.9*2.65
DN25:	34	33.7*3.25

- ANSI/ISO:		
DN15:	38	21.34*3.73
DN20:	41,5	26.67*3.91
DN25:	44.5	33.40*4.55

b) Gwinty żeńskie:

- ISO7-1 / ISO228-1:	ANSI:
Rp1/2" odpow. G1/2"	NPT1/2"
Rp3/4" odpow. G3/4"	NPT3/4"
Rp1" odpow. G1"	NPT1"

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane

dla wykonania standardowego!

Modyfikacja zastrzeżona.

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnal wyjściowy:	
-------------------	--

Długość pomiarowa:

typ:


Napięcie zasilające, V:		AC/DC:	
-------------------------	--	--------	--

Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka:
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.)

Wykonania specjalne, uwagi:

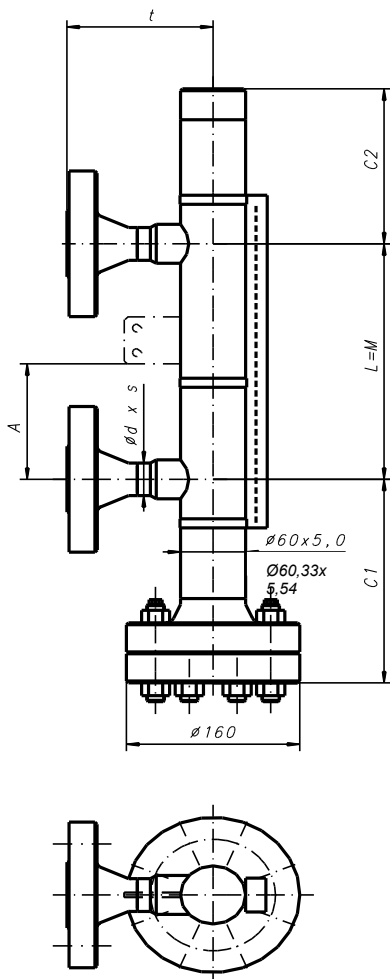

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm³
Ciśnienie pracy : max. 200bar(g) @ 20 °C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1)
Temperatura projektowa : "

g/cm³:
bar(g):
bar(g):
°C:
°C:

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!
Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka: 316/316L
Pływak: stop tytanu typ:
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard
czyste PTFE bez wzmocnienia
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytk: Srebro-czerwona nr: 34837 Standard
Al, kat.-nr. 20010405: Płytk: nr:

Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr. mm:

Przylączy kołnierze PN250 wg DIN-EN:

- przyłga kołnierza typu E, Rz=16 DN15:
- kołnierze wg DIN2628 DN25:

Przylączy kołnierze wg ANSI-ISO , klasa 1500/PN250:

- przyłga, "klasyczna" (= "wykończenie płaskie") 1/2" bzw. DN15 :
- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2 3/4" bzw. DN20 :
1" bzw. DN25 :

Inne przylączy:

--	--

Zasięg pływaka dolny / górny:

c1: c2:
Standard 205 155
Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przylączy kołnierze:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przylączy, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*3.73
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*3.91
DN25:	33.7*3.25	33.40*4.55
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*4.55
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przylączy

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!

Modyfikacja zastrzeżona.

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:


Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka: ☐
Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.) ☐

Wykonania specjalne, uwagi:

--	--

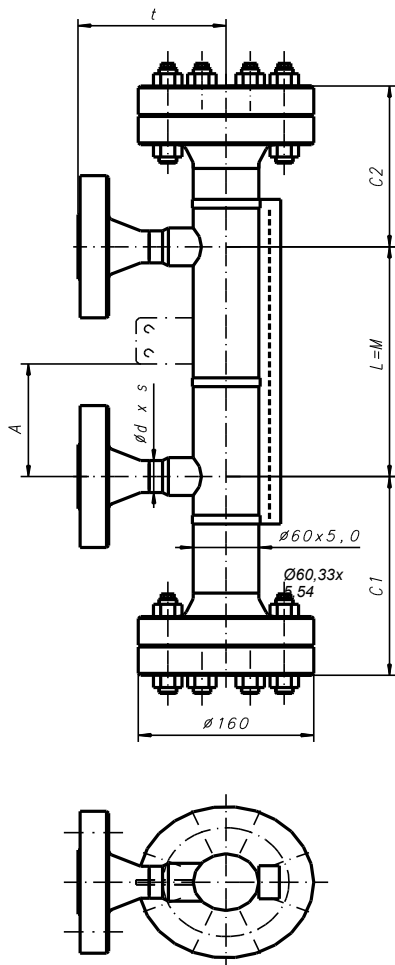

Zasięg pływaka dolny / górny:

	c1:	c2:
Standard	205	155

Na życzenie: c1, c2 krótsze lub dłuższe,
W zależności od pływaka!

Standardowe przyłącza kołnierkowe:

	DIN/EN	ANSI/ISO
Przyłącza, d*s:		
DN15:	21.3*2.65	21.34*3.73
DN20:	(26.9*2.65)	26.67*3.91
DN25:	33.7*3.25	33.40*4.55
>= DN32 *2):	33.7*3.25	33.40*4.55
Wymiar t:		
DN15:	150	150
DN20:	(150)	150
DN25:	150	150
>= DN32 *2):	tba na życzenie 3)	

*2) z kołnierzami zredukowanymi

*3) w zależności od wielkości kołnierzy przyłączyeniowych

*4) urządzenia zależne od wskaźnika
zgodnie ze specyfikacją nr 20010501!

- wszystkie wymiary podano "mm"!

Wymiarowanie podane
dla wykonania standardowego!
Modyfikacja zastrzeżona.

Dane zamówienia:

Firma :
Numer zamówienia :
Projekt:
Ilość:

nr TAG:	

Parametry pracy :

Czynnik :
Gęstość : min 0.6g/cm3
Ciśnienie pracy : max. 200bar(g) @ 20 °C *1)
Ciśnienie projektowe : "
Temperatura pracy : -10 °C bis max. 400 °C *1)
Temperatura projektowa : "

g/cm3:	
bar(g):	
bar(g):	
°C:	
°C:	

*1) Należy zapoznać się z przebiegiem ciśnienia i temperatury!

Dolny zakres ciśnienia i temperatury każdego kołnierza lub dopasowania zastrzeżony!

Test ciśnienia będzie specyfikowany wg firmy WEKA "Informacje ciśnienia i temperatury"

Konstrukcja i materiały:

Komora pływaka: standardowe wykonanie: 316/316L
Pływak: stop tytanu typ:
Śruby DIN 2510 L: 21CrMoV57-DIN17240 (dwustronne antyzmęczenia)
Nakrętki sześć. DIN2510 NF: 21CrMoV57-DIN17240
Uszczelki: Włókno Aramidowe/NBR Standard ☐
czyste PTFE bez wzmocnienia ☐
Grafit ze wzmocnieniem 316/316L ☐

Wskaźnik:

PC, kat.-nr. 990805: Płytki: Srebrno-czerwona nr: 34837 Standard ☐
Al, kat.-nr. 20010405: Płytki: nr:
Rozstaw króćców : max. 5600mm jednoczęściowa konstr. mm:

Przyłącza kołnierkowe PN250 wg DIN/EN:

- przyłącza kołnierkowe typu E, Rz=16 DN15: ☐
- kołnierze wg DIN2628 DN25: ☐

Przyłącza kołnierkowe wg ANSI/ISO , klasa 1500/PN250:

- przyłącza, "klasyczna" (= "wykończenie płaskie") 1/2" bez. DN15 : ☐
- kołnierze wg ANSI/ASME B16.5 / ISO-DIS7005-1.2 3/4" bez. DN20 : ☐
1" bez. DN25 : ☐

Inne przyłącza:

--

Akcesoria:

Podpora montażowa nr. 26936: wymiar "A", mm:

Wyłącznik magnetyczny *4): typ: ilość:

Sensor *4): typ:

Sygnał wyjściowy:

Długość pomiarowa:

Regulator: typ:

Napięcie zasilające, V: AC/DC:

Pozostałe akcesoria:

Opcjonalnie:

Atesty wykonania materiałowego zgodnie z EN10204-3.1 dla komory pływaka: ☐

Specjalne mocowanie wskaźnika, specyfikacja nr 20010407 (wibracje, wstrząsy itp.) ☐

Wykonania specjalne, uwagi:

--